


# Cânula de Punção Descartável

Registro ANVISA nº: 80777280030

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização em Raios Gama
- Válido por 2 anos
- Descartável
- Aço Inoxidável

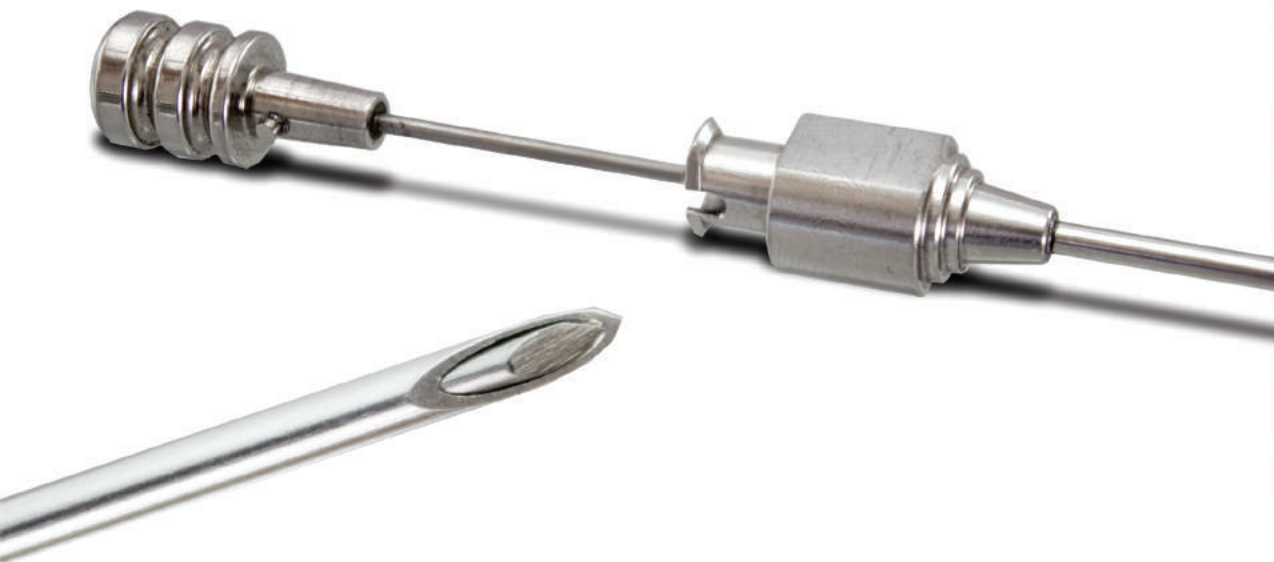

### Kit Cânula de Punção 1

cod. 051 01 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
1 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,3 x 230 mm

### Kit Cânula de Punção 2

cod. 051 02 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
2 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,3 x 230 mm

### Kit Cânula de Punção 3

cod. 051 03 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
3 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,3 x 230 mm

### Kit Cânula de Punção 4

cod. 051 04 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
1 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,5 x 230 mm

### Kit Cânula de Punção 5

cod. 051 05 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
2 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,5 x 230 mm

### Kit Cânula de Punção 6

cod. 051 06 00 00

1 unid.	Cânula de Punção Ø 2,2 x 220 mm
3 unid.	Fio Guia de Nitinol Ø 1,5 x 230 mm

SETORMED



# Drill

Registro ANVISA nº: 80777280013

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade máxima: 30.000 rpm
- Sistema de Encaixe Setormed
- Acessório: Caixa de Esterilização



018 05 00 00	Drill com Mandril Ø 0 até 8mm x 140,0mm
018 12 00 00	Drill Reto Ø 2,38mm x 130,0 mm
018 16 00 00	Drill Reto Curto Ø 2,38mm x 80,0 mm
018 17 00 00	Drill Perfurador Reto Encaixe Setormed Ø 13,0mm x 130,0 mm
018 01 00 00	Drill Reto Ø 2,38mm x 122,0 mm
018 13 00 00	Drill Angular Ø 2,38mm x 145,0 mm
018 02 00 00	Drill Angular Ø 2,38mm x 132,0 mm

# Craniótomo

Registro ANVISA nº: 80777289004

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Sistema de Encaixe Setormed
- Utiliza Fresas Cirúrgicas Setormed
- Velocidade Máxima: 30.000 rpm
- Acessório: Caixa de Esterilização, Chave



SETORMED




# Endoscópios para Artroscopia

Registro ANVISA nº: 80777280028

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Diâmetro: 2,3 | 2,7 | 4,0 mm
- Longitude: 80 | 110 | 175 | 275 mm
- Ângulo: 0° | 30° | 70°
- Acessório: Caixa de Esterilização

## Segurança

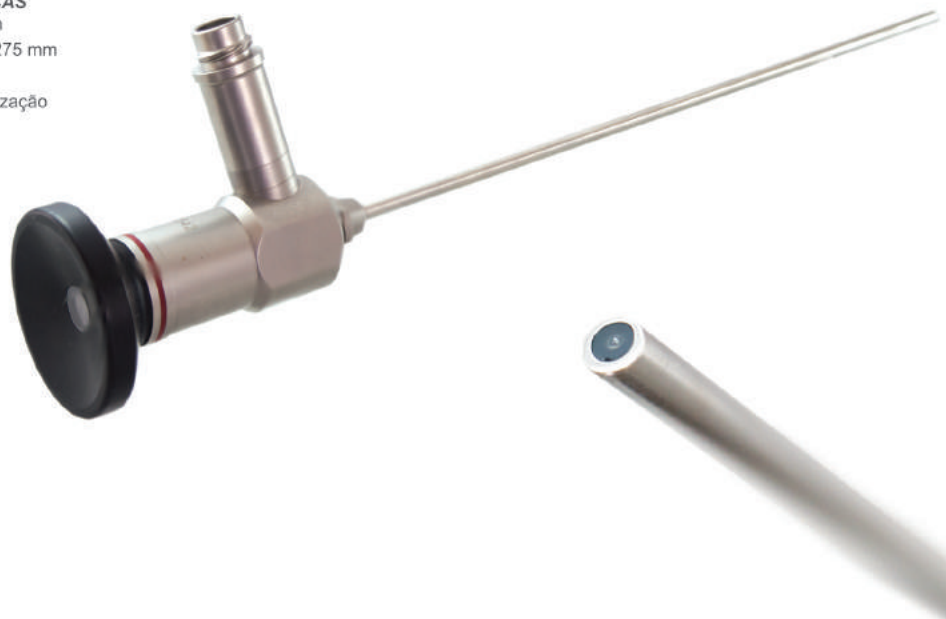

# Trocater

Registro ANVISA nº: 80777280001

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Diâmetro: 2,3 | 2,7 | 4,0 mm
- Longitude: 80 | 110 | 175 | 275 mm
- Ângulo: 0° | 30° | 70°
- Acessório: Caixa de Esterilização



## Trocater 110mm

0°	Ø2,7mm	cod. 008 10 00 02
30°	Ø2,7mm	cod. 008 11 00 02
70°	Ø2,7mm	cod. 008 12 00 02
0°	Ø4,0mm	cod. 008 01 00 04
30°	Ø4,0mm	cod. 008 02 00 04
70°	Ø4,0mm	cod. 008 03 00 04

## Trocater 175mm

0°	Ø4,0mm	cod. 008 04 00 04
30°	Ø4,0mm	cod. 008 05 00 04
70°	Ø4,0mm	cod. 008 06 00 04

## Trocater 275mm

0°	Ø4,0mm	cod. 008 07 00 04
30°	Ø4,0mm	cod. 008 08 00 04
70°	Ø4,0mm	cod. 008 09 00 04



# Fresas Cirúrgicas

Registro ANVISA nº: 80777280012 | 80777280014

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização em Raio Gama
- Válido por 2 anos
- Aço Inoxidável



<p><b>Broca para Buco Maxilo</b></p> <p>Comprimento da Haste: 110   115   120   150 155   180 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 0,9   1,0   1,1   1,2   1,3   1,4   1,5 1,6   1,7   1,8   1,9   2,0   2,1   2,2 2,3   2,7   3,2   3,5 (mm)</p>	<p><b>Fresa Esférica de Desbaste</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95   125 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 0,6   0,7   0,8   1,0   1,4   1,8 2,3   2,7   3,1   3,5   4,0   4,5 5,0   6,0   7,0 (mm)</p>	<p><b>Fresa Esférica de Corte Rápido</b></p> <p>Comprimento da Haste: 115 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   6,5 4,0   4,5   5,0   5,5   6,0   7,0 (mm)</p>	<p><b>Fresa Esférica de Acabamento</b></p> <p>Comprimento da Haste: 115 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 0,6   0,7   0,8   1,0   1,4   1,8   2,0 2,3   2,5   2,7   3,0   3,5   4,0   4,5 5,0   5,5   6,0 (mm)</p>
--	---	--	--

<p><b>Fresa Cônica de Ponta Redonda</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95   125 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 5,0   7,0 (mm)</p>	<p><b>Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95   125 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 5,0   7,0 (mm)</p>	<p><b>Fresa de Corte Lateral</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95   125 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 2,1 (mm)</p>	<p><b>Fresa Esférica Diamantada</b></p> <p>Comprimento da Haste: 44,5   55   70   95 125 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 0,6   0,7   0,8   1,0   1,4   1,8   2,0 2,3   2,5   2,7   3,0   3,5   4,0   4,5 5,0   5,5   6,0 (mm)</p>
--	--	---	---

<p><b>Fresa Cônica de Corte Helicoidal</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 4,0   4,5   6,0 (mm)</p>	<p><b>Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido</b></p> <p>Comprimento da Haste: 95 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 0,6   0,7   0,8   1,0   1,2   1,5   1,8 2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   5,0 5,5   6,0   6,5 (mm)</p>	<p><b>Broca Craniótomo</b></p> <p>Comprimento da Haste: 44 (mm)</p> <p>Encaixes: R   O   J   T   S   M</p> <p>Diâmetro da Broca: 2,5 (mm)</p>	<p><b>Broca Auto Bloqueante</b></p> <p>Encaixes: Hudson</p> <p>Diâmetro da Broca: 11,0   14,0 (mm)</p> 
---	---	---	--



# Kit Cãnula de Debridaço

Registro ANVISA n<sup>o</sup>: 80777280047

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilizaço em Raios Gama
- Válido por 2 anos
- Descartável



Específico para cirurgias minimamente invasivas de coluna.

## Encaixes

Tipo 01 A



Tipo 03 A



Tipo 05 A



Tipo 07 A



Tipo 08 A



**APC**  
Agressivo do Perfil Completo  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)



**RPC**  
Ressector do Perfil Completo  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)



**CM**  
Cortador de Menisco  
4,5 | 5,5  
6,5 (mm)



**INC**  
Incisivo  
4,5 | 5,5  
6,5 (mm)



**CMA**  
Contador de Menisco Agressivo  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)



**BA**  
Broca Afilad  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)



**BO**  
Broca Oval  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)



**BR**  
Broca Redonda  
3,5 | 4,2  
4,5 | 5,5 (mm)

SETORMED










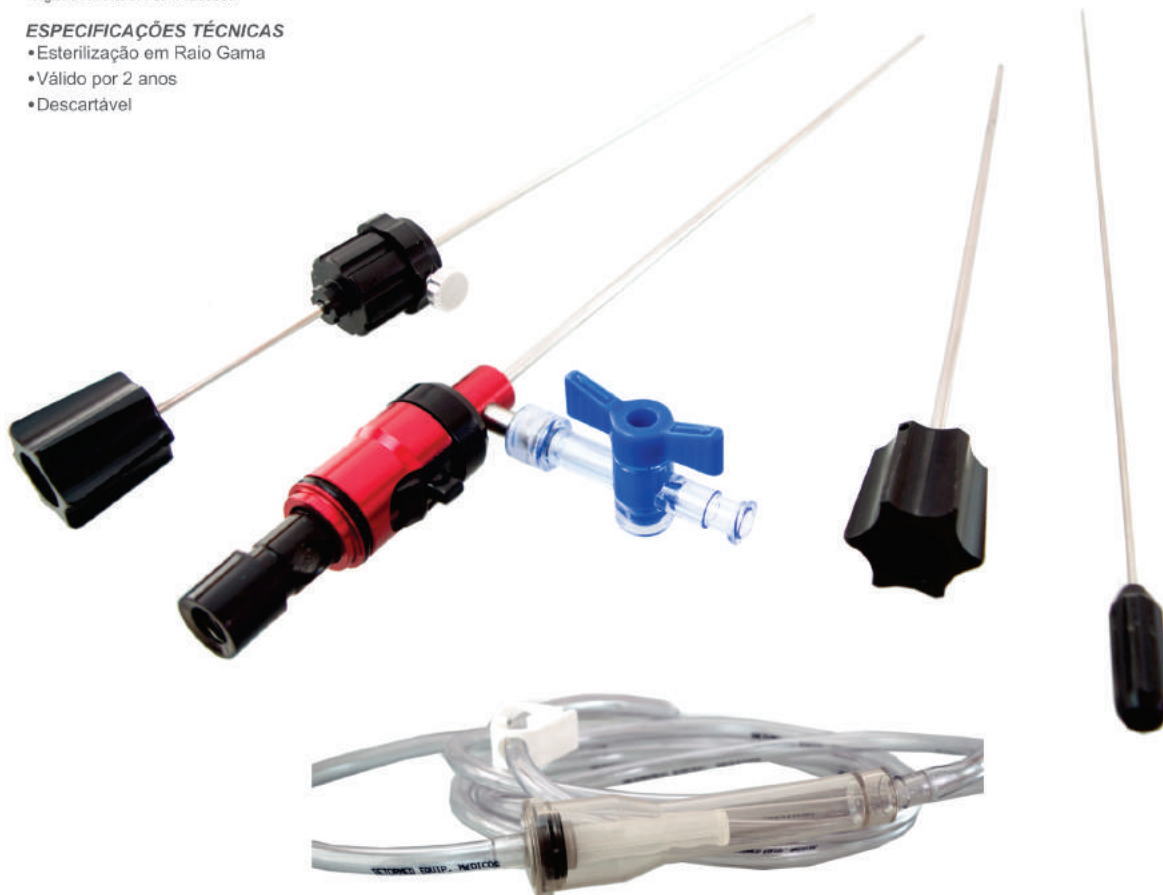





# Kit Cânulas para Cirurgia Percutânea de Disco

Registro ANVISA nº: 80777280033

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização em Raio Gama
- Válido por 2 anos
- Descartável



		<b>Cervical</b>	cod. 050 02 00 00	Trocater 95 mm
		<b>Lombar</b>	cod. 050 01 00 00	Trocater 165 mm
		<b>Cervical</b>	cod. 050 04 00 00	Obturador 115 mm
		<b>Lombar</b>	cod. 050 03 00 00	Obturador 185 mm
		<b>Cervical</b>	cod. 050 04 00 00	Obturador 115 mm
		<b>Lombar</b>	cod. 050 03 00 00	Obturador 185 mm
		<b>Cervical</b>	cod. 050 04 00 00	Obturador 115 mm
		<b>Lombar</b>	cod. 050 03 00 00	Obturador 185 mm
<b>Acessórios</b>				
Peça de Mão do Fio Guia cod. 050 07 00 01	Fio Guia 260 mm cod. 050 07 00 02	Tubo Aspirador com Coletor 5m cod. 050 12 00 00	Tubo Injetor de Contraste 260 mm cod. 050 15 00 00	
				

SETORMED



# Perfurador Canulado

Registro ANVISA nº: 80777289006



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade Máxima: 1000 rpm
- Velocidade Mínima: 400 rpm
- Canulado até: 4.0 mm
- Autoblocante
- Capacidade do Mandril: 0 - 6,5 mm
- Pressão Necessária: 80 - 120 psi // 7.0 - 10 kgf/cm<sup>2</sup>
- Fluxo Necessário: 340 L/min // 12 cubic feet/min
- Tipo de Gás: N<sup>2</sup>, ar comprimido com filtro seco.
- Peso da Peça de Mão: 1,2 Kg com mandril
- Acessórios: caixa de esterilização, mandril com chave, regulador de pressão, lubrificante e mangueira

# Turbina Pneumática

Registro ANVISA nº: 80777289005

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Pressão Necessária: 80-120 psi // 7.0 - 10 Kg/ cm<sup>2</sup>
- Fluxo Necessário: 340 L/ min // 12 cubic feet / min
- Tipo de Gás: N<sup>2</sup>, ar comprimido com filtro seco
- Perfurador: 30.000 rpm
- Acessório: Caixa de Esterilização



**Inclui Pedal  
e Manômetro**

SETORMED



# Ponteiras de Ablação

Registro ANVISA nº: 80777280027

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização em Raios Gama
- Válido por 2 anos
- Descartável
- Ângulação: 30° | 45° | 60° | 90°
- Modelos: Bola, canal e cavado



### Tipo Mini

Reto	Ø2,5mm	cod. 010 06 01 01
90°	Ø2,5mm	cod. 010 06 06 01

### Tipo Bola

Reto	Ø2,5mm	cod. 010 04 01 02
30°	Ø2,5mm	cod. 010 04 02 02
60°	Ø2,5mm	cod. 010 04 05 02
90°	Ø2,5mm	cod. 010 04 06 02

### Tipo Canal

Reto	Ø2,5mm	cod. 010 05 01 02
30°	Ø2,5mm	cod. 010 05 02 02
60°	Ø2,5mm	cod. 010 05 05 02
90°	Ø2,5mm	cod. 010 05 06 02

### Tipo Cavado

Reto	Ø2,5mm	cod. 010 06 01 02
30°	Ø2,5mm	cod. 010 06 02 02
45°	Ø2,5mm	cod. 010 06 04 02
60°	Ø2,5mm	cod. 010 06 05 02
90°	Ø2,5mm	cod. 010 06 06 02

# Ablation

Registro ANVISA nº: 80777280046

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Ponteira de radiofrequência para corte, ablação e coagulação
- Caneta Monopolar





# Kit Cãnula para Coluna Toracobar Axilaser Spine Fiber

Registro ANVISA nº: 80777280075

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilização em Raios Gama
- Valido por 2 anos
- Descartável



### *Cabo de Fibra Ótica*

Multimode Fiber | 0.39 NA | 400µm

Multimode Fiber | 0.39 NA | 600µm

SETORMED

